

# 洛氏硬度计使用说明书

## HR-150A

本机执行标准为： GB/T230.2-2002《金属洛氏硬度试验 第2部分：硬度计(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的检验与校准》、欧洲标准 BSEN10109-96《金属材料硬度试验》、国际标准 ISO6508.2《金属材料-洛氏硬度试验-硬度计的检验与校准》。

北京时代山峰科技有限公司

## 1 概述

### 1.1 适用范围

**HR-150A** 洛氏硬度计采用洛氏 (ROCKWELL) 测量原理 (见附录 1), 可直接进行洛氏硬度测量, 操作简单, 示值稳定, 维护方便。适用于硬质合金、碳钢、合金钢、铸铁、有色金属等材料的洛氏硬度检测, 可广泛应用于计量、机械制造、冶金、建材等行业的检测、科研与生产。

本机执行标准为: GB/T230.2-2002《金属洛氏硬度试验 第 2 部分: 硬度计(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T 标尺)的检验与校准》、欧洲标准 BSEN10109-96《金属材料硬度试验》、国际标准 ISO6508.2《金属材料-洛氏硬度试验-硬度计的检验与校准》。

1.2 测定硬度范围: 20~88HRA, 20~100HRB, 20~70HRC。

## 2 主要性能参数

- 初试验力: 98.1N (10kgf)
- 总试验力: 588.4N(60kgf), 980.7N(100kgf), 1471N(150kgf)
- 洛氏硬度标尺刻度 HRC: 0~100, HRB: 0~100
- 测试分辨率: 0.5 洛氏单位
- 垂直方向最大测试空间: 200mm
- 水平方向压头轴线距前壁: 160mm
- 最大外形尺寸: 580mm×270mm×740mm
- 净重: 100kg

## 3 基本配置与结构

3.1 标准配置:	主机	1
	A 标尺标准硬度块	1
	B 标尺标准硬度块	1
	C 标尺标准硬度块	1
	Φ1.5875mm 球压头	1
	Φ1.5875mm 备用球	3
	120° 金刚石圆锥压头	1
	压头紧定螺钉	1
	φ60mm 平面样品台	1
	φ60mm V 型样品台	1
	仪器罩	1
可选附件:	φ70mm 平面样品台	
	φ70mm V 型样品台	
	φ80mm 平面样品台	
	φ80mm V 型样品台	
	φ120mm 平面样品台	
	φ150mm 平面样品台	
	小 V 型/点状两用样品台	
	其他硬度范围的标准硬度块	

### 3.2 结构示意图

**HR-150A** 洛氏硬度计外观见图 3.1; 硬度指示表见图 3.2。



图 3.1



图 3.2

#### 4 安装与调整

- 4.1 硬度计安装环境应干燥、清洁、无腐蚀性介质，温度（10~35）℃，无强磁场干扰；并应安装在坚固、平稳、无振动的基础平台上；平台上另需预留一个Φ60mm圆孔，使得丝杠升降自如，丝杠向下运动最大极限位置为低于台面 220mm，该范围内应无障碍物。开孔位置与硬度计底座相对位置示意图见图 4.1。

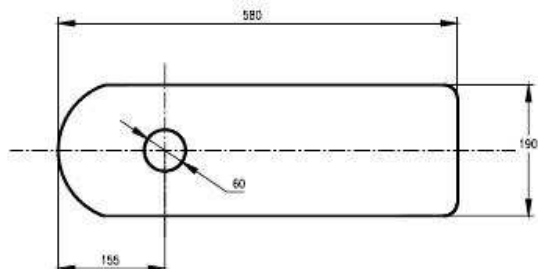


图 4.1

- 4.2 开箱后拆除硬度计底部紧固在底托板上的螺钉，此时先不要将硬度计从枕木上搬下来，需要先安装随机附带的四个底脚螺钉。安装好底脚螺钉后，即可将硬度计搬运到准备好的平台上。搬运时必须搬其底部，禁止从其他部位作为施力部位搬运。

**特别提示:HR150A 体积大重量沉，安装、搬运、运输时应使用合适的起重设备和牢固的紧固手段，以免发生事故。运输时应取下砝码组，长途运输过程应恢复原有包装，取下压头，并用弹性物固定主轴、杠杆，以免损坏机件。**

- 4.3 逆时针转动手轮，降下样品台，去掉防震胶垫及所有包装物；然后将准确度为 0.2mm/m 的水平仪放置在样品台上，调整硬度计底脚螺钉，调水平后紧固锁紧螺母。
- 4.4 打开硬度计上盖和后盖，去掉所有运输中防震防松用的扎带或弹性物。将砝码组挂在杠杆尾部的环状 V 型槽中。注意必须保证刀口正确安装在 V 型槽内。见图 4.2。



图 4.2

- 4.5 加载时间的校验可以通过缓冲器上的油针旋出或旋入程度来调整。具体方法是：装上球压头，选择 980.7N 试验力，将 B 标尺硬度块放在样品台上，上升样品台。施加初试验力直到硬度指示表小指针指示红点处，大指针指示 B 处，见图 4.3。



图 4.3

将加载手柄推向加载方向，观察指示表大指针开始逆时针方向转动至停止所用的时间，并记录。如果施加时间不在 3~6 秒范围内，可以通过缓冲器上的油针旋出或旋入程度来调整，旋入时间延长，旋出时间缩短。调整后应将油针锁紧。

#### 4.6 装好上盖和后盖。

### 5 操作使用方法

#### 5.1 测试准备

根据被测试样的材质、硬度范围选用硬度标尺，从而选择试验参数。表 5.1 列出本机可测的标尺参数及适用材料。

表 5.1

标尺	压头	试验力 (N)		硬度指示表刻度	刻度范围	常用范围	应用材料举例
		初试验力	总试验力				
HRA	金刚石圆锥压头	98.1	588.4	C (黑)	0~100	20~88	硬质合金、表面渗碳淬火钢
HRB	Φ1.5875mm 球压头	98.1	980.7	B (红)	0~100	20~100	软钢、铝合金、铜合金、可锻铸铁
HRC	金刚石圆锥压头	98.1	1471	C (黑)	0~100	20~70	淬火钢、调质钢、合金钢

#### 5.2 安装压头

压头安装在主轴孔中，安装压头时必须保证主轴孔、端面、压头尾柄和轴肩清洁无异物。安装时先用压头紧定螺钉轻轻顶在尾柄平面处，然后加载主试验力，当总试验力全部加上后，即在保持总试验力的状态下，旋紧压头紧定螺钉；最后卸载，压头安装完成。

#### 5.3 试验力的选择

试验力的选择通过硬度计右侧试验力选择旋钮进行，见图 5.1，可以选择 588.4N(60kgf)，980.7N(100kgf)，1471N(150kgf)三种试验力。注意：试验力的切换必须是在卸载状态下进行，否则可能损坏压头。





图 5.1

#### 5.4 硬度测试

- 5.4.1 将被测试样平稳放在样品台上，使试样与样品台表面紧贴，然后顺时针旋转手轮使样品台上升；试样与压头接触后继续旋转手轮，直到硬度指示表小指针指示红点处，大指针指示 C 或 B 附近，偏移不超过±5 个硬度值；拨动调整把手，使大指针对准 C 或 B 刻度线，见图 5.2。否则更换测试位置，重新开始。



图 5.2

- 5.4.2 将加载手柄推向加载方向，施加主试验力，直到指针转动变慢，基本不动，总试验力保持时间应在 2~6 秒范围内。高硬度值的试样保持时间可以取短，低硬度值的试样一般宜取长。然后将加载手柄扳回到卸载位置，卸除主试验力。
- 5.4.3 按硬度指示表大指针指示的刻度读取硬度值。当测试 HRC、HRA 标尺时按刻度表外圈标记为 C 的黑字读数；当测试 HRB 标尺时按刻度表内圈标记为 B 的红字读数。如图 5.3 当测试 HRC（即试验参数为金刚石圆锥压头，试验力 1471N）时硬度值为 64.5HRC；如果是测试 HRA（即试验参数为金刚石圆锥压头，试验力 588.4N），则硬度值 64.5HRA；如果是测试 HRB（即试验参数为  $\Phi 1.5875\text{mm}$  球压头，试验力 980.7N），则硬度值 94.5HRB。



图 5.3

5.4.4 降下样品台，卸载全部试验力，测试完毕。

#### 5.5 注意事项

5.5.1 一般情况下，当更换压头、样品台或试样后，前 1~2 次测试无效，后几次测试取平均值，较为准确。

5.5.2 在凸圆柱面、凸球面上测试的结果应按 GB/T230.1-2002《金属洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T 标尺）》中的相关规定进行修正。

## 6 维护、保养与注意事项

6.1 定期用标准块检查硬度计示值误差，当误差超出 GB/T230.2-2002《金属洛氏硬度试验 第 2 部分：硬度计的检验与校准》允许范围时，应进一步检查试验力是否准确，或压头是否有缺陷和变形。硬度计周期检定与校准应按国家相关标准规定进行。

6.2 装卸压头应认真仔细，保证顶端无损伤、无污染，安装面清洁无异物。长期不用应卸下妥善保管，涂防锈油。

6.3 样品台及标准硬度块表面应清洁无污染，无划痕、擦、碰伤；保存时涂防锈油防锈。

6.4 测试时被测样品必须平稳放置，支承可靠，确保在测试过程中无任何位移、变形。

6.5 升降丝杠应定期润滑。具体方法为：取下样品台及丝杠护套，向丝杠上注入数滴轻质润滑油，然后转动手轮，反复升降丝杠，使润滑油分布均匀。最后重新装好护套等物。注意润滑油不宜注入过多。

6.6 日常工作环境及关机后应注意防尘、防腐蚀介质。在潮湿地区，应经常注意防锈


6.7 搬运硬度计时必须卸下砝码、压头，并在压头座与样品台之间夹防震胶垫；长途运输时必须恢复原有包装和保护措施。

6.8 缓冲器经长时间使用后，油可能损耗或变质，此时应更换新油。更换方法是将底部的放油螺钉旋出，将污油排净，再将放油螺钉旋紧；然后将 30 号机油由缓冲器上端加入缓冲器。在加油过程中，应将加载手柄前后扳动几次，以便排出缓冲器中的空气。

6.9 当硬度计出现非正常现象时，请勿自行拆卸或调节任何固定装配的零配件；请填写保修卡后，交本公司维修部门处理。

## 附录 1 洛氏硬度测量方法与原理

洛氏硬度测量实际测量的是压痕深度，将在规定的试验条件下所测得的压痕深度换算为硬度单位。具体按以下步骤进行，见附图 1。

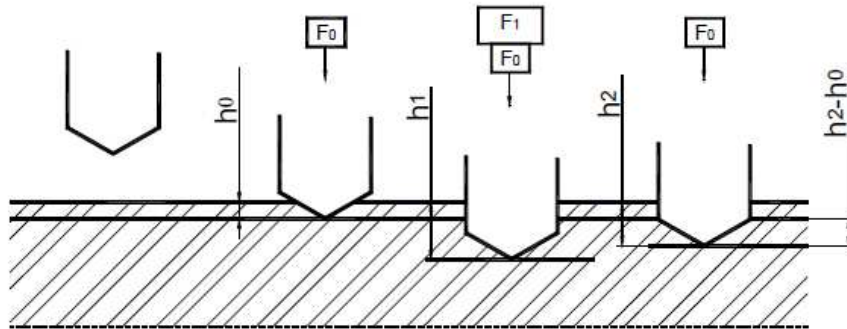

附图 1

- (1) 首先加载初试验力  $F_0$ ，将压头（金刚石圆锥压头或球压头）压入试件表面，计初始位移  $h_0$ 。
- (2) 然后加载主试验力  $F_1$ ，保持一定时间，此时压头位移为  $h_1$ ，之后卸除主试验力  $F_1$ 。
- (3) 保持初试验力  $F_0$ ，测量此刻的压头位移  $h_2$ 。
- (4) 按下述公式，计算出洛氏硬度值（式中位移单位为 mm）


标尺	应用公式
A, D, C	$HR=100- (h_2-h_0) /0.002$
E, B, G, H, F, K, P, M, L, R, S, V	$HR=130- (h_2-h_0) /0.002$




## 附录 2 试样最小厚度要求

试样最小厚度要求取决于该材料硬度和所用标尺，一般要求试验后，试样背面不得有肉眼可见的变形痕迹。

试样最小厚度与材料硬度及所用标尺存在附图 2、附图 3 关系图。

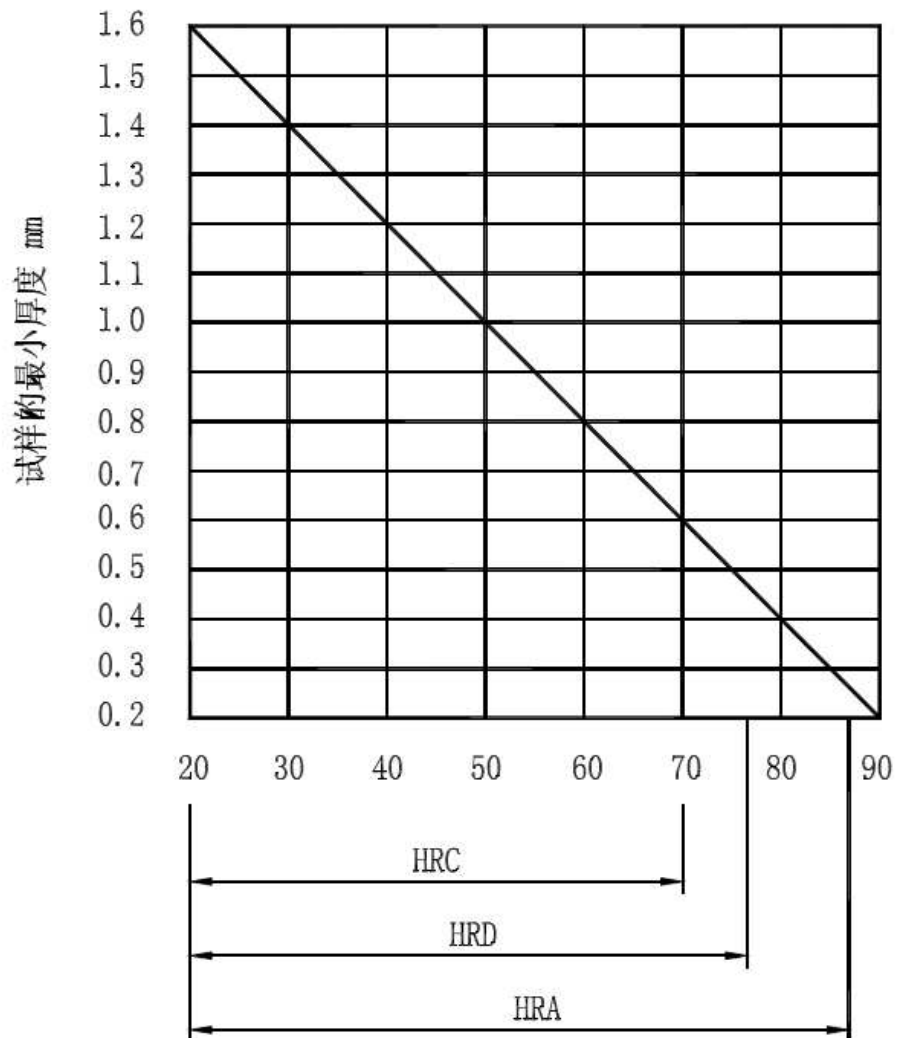

附图 2 用金刚石圆锥压头试验 (HRA、HRC、HRD)

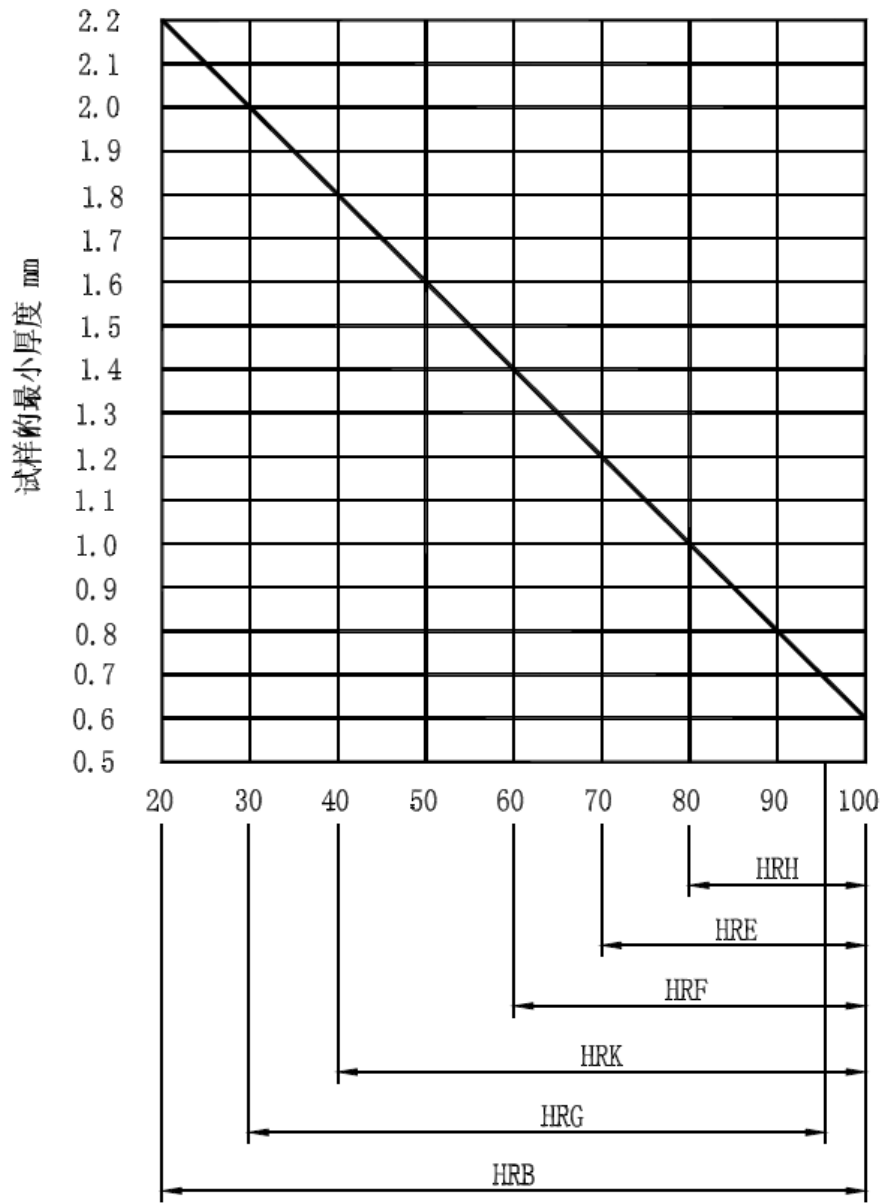

附图 3 用钢球压头试验 (HRB、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK)

# 合格证

产品名称： 洛氏硬度计

产品型号： HR-150A

出厂编号： \_\_\_\_\_

本机执行标准为： GB/T230.2-2002《金属洛氏硬度试验 第2部分：硬度计(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的检验与校准》、欧洲标准 BSEN10109-96《金属材料硬度试验》、国际标准 ISO6508.2《金属材料-洛氏硬度试验-硬度计的检验与校准》。

根据检验结果，该产品合格，准予出厂。

质检员：

检验日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

北京时代山峰科技有限公司



# 2008 年新品推荐

## TH3200 全洛氏硬度计

自动数显全洛氏硬度计，可以自动进行洛氏硬度和表面洛氏硬度测量  
压头水平方向探出，可以测试普通硬度计无法测到的表面，如环状、管状、框类零件内表面，底台等功能齐全，可以测试 30 种洛氏硬度制式，包括塑料洛氏  
加荷、保荷、卸荷由电脑精确控制，准确满足最新国家标准和 ASTM 标准  
中英文双语菜单，大屏幕、高清晰、高亮度背光点阵 LCD 显示屏  
键盘操作简洁明了，易学易用  
HB、HV、HLD、HK 多种硬度制式转换以及抗拉强度转换  
400 组测量数据、测试时间、测试序号自动存储，随时查阅或打印  
具有 USB、RS232 双通讯口，可外接打印机；或将测试结果传输到计算机  
符合所有国际洛氏硬度测试标准，包括美国标准 ASTM E-18、国际标准 ISO6508、欧盟标准 BS EN6508 以及中国标准 GB/T230.2

### 全国免费安装调试

### 建议零售价格：58000 元



## 装 箱 卡

序号	名 称	数量	单 位	备注
1	HR-150A 主机	1	台	标配
2	金刚石压头	1	只	标配
3	球压头	1	个	标配
4	平台	1	个	标配
5	洛氏 C 硬度块	1	块	标配
6	洛氏 B 硬度块	1	块	标配
7	洛氏 A 硬度块	1	块	标配
8	使用说明书	1	本	标配
9	V 型台	1	个	标配
10	球头	5	个	标配

装箱检验员： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

北京时代山峰科技有限公司

北京时代山峰科技有限公司	
单位名称	
联系地址	
联系人	
联系电话	
产品型号	
主机编号	
传感器编号	
购机日期	
<p><b>注意事项:</b></p> <p>一、本公司产品实行三个月内保换，一年内保修，并负责仪器的终身维修。</p> <p>二、保修期内出现质量故障（非保修件除外），请凭“保修登记卡”或购机发票复印件可免费维修；超过保修期的本公司产品出现故障，按公司规定收取维修费用。</p> <p>三、凡因用户自行拆装本公司产品、因运输、保管不当或未按产品说明书正确操作造成产品损坏，以及私自涂改保修卡，无购货凭证，本公司均不能予以保修。</p> <p>四、用户必须认真填写本卡，并在购机后两周内将加盖用户单位公章的《保修登记卡》和购买仪器发票复印件寄回（或传真）本公司客户服务中心。手续不全时，只能维修不予保修。</p> <p>感谢您使用我司产品有问题免费拨打全国统一售后电话：TEL:010-82951585 010-82946733</p> <p>北京时代山峰科技有限公司</p>	
发票复印件粘贴处	

